

平成 29 年 12 月

「HBs抗体精密」検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび標記項目の測定に使用する基準物質の変更（WHO 1st から WHO 2nd へ変更）に伴い、検査内容を変更させていただきますので、ご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。



敬具

（ 記 ）

- 変更項目 [687]HBs抗体精密
- 変更期日 平成30年2月1日(木) 受付分より
- 変更内容

変更箇所	新	旧	備考
報告下限	2.5未満 mIU/mL	0.1 mIU/mL	CLSI ガイドラインに従って検証された定量限界へ変更

■ 新旧二法の相関

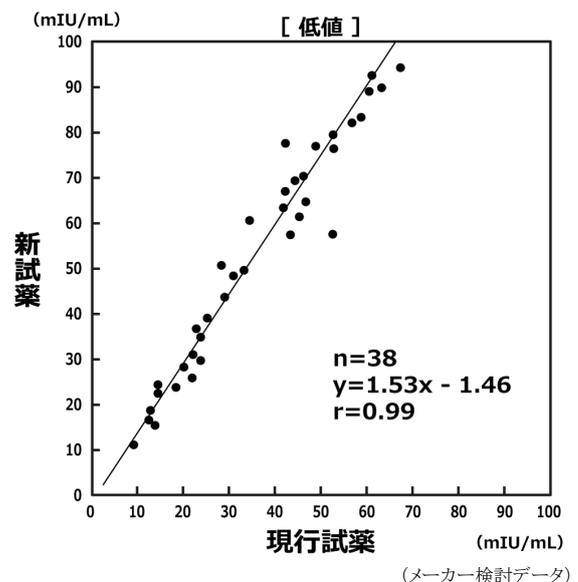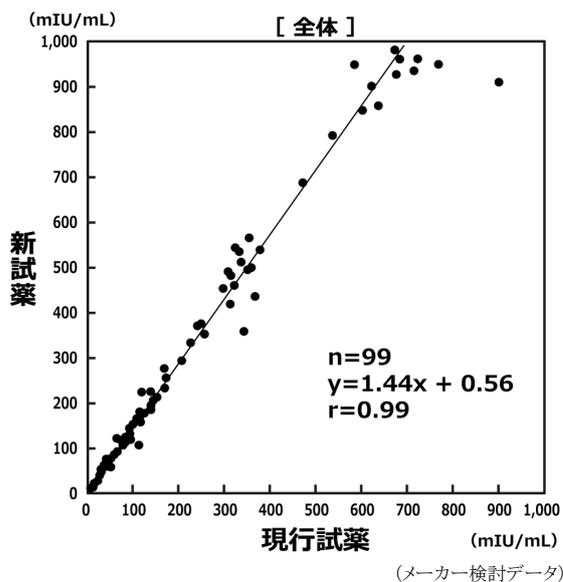

■ 参考文献

出口松夫, 他: 医学と薬学 74:1137-1144, 2017.

以上
No. 17-30